


# NOTICE D'UTILISATION ABRÉGÉE POUR LE TEST ANTIGÉNIQUE INDIVIDUEL




Produit : test antigénique CLINITEST® Rapid COVID-19

Fabricant : Siemens Healthineers


## Premières étapes

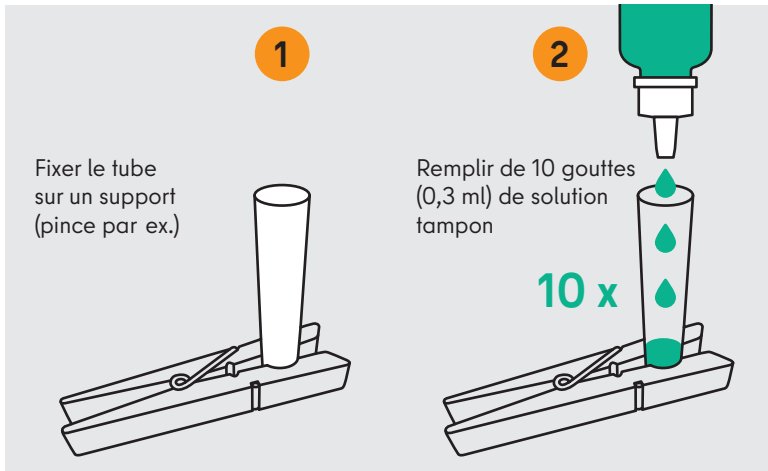


## Prélèvement de l'échantillon (à la température ambiante)

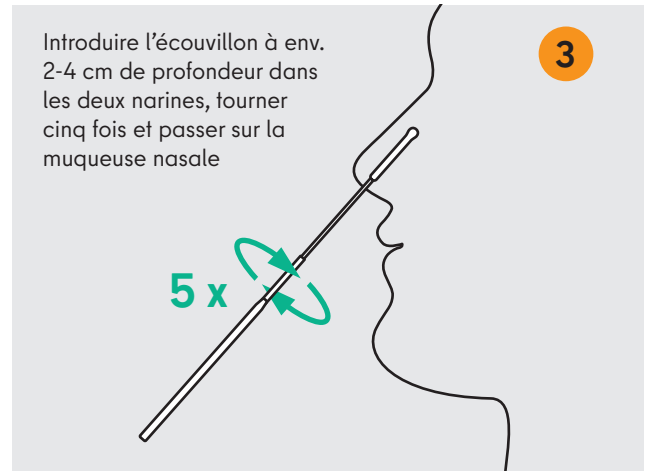

## Traitement de l'échantillon

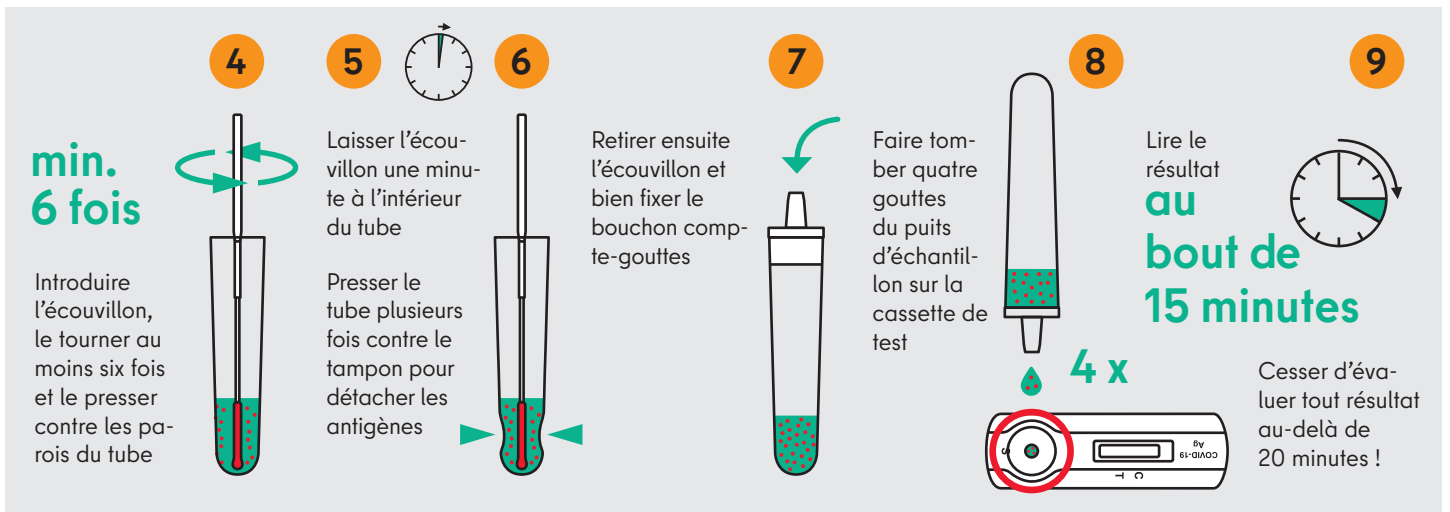

## Évaluation des résultats

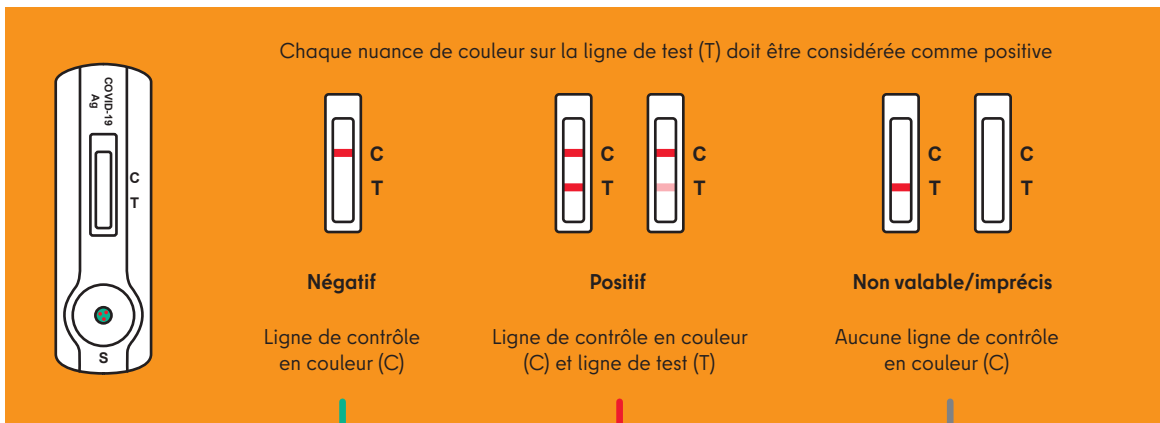

## Élimination



Les élèves, ainsi que le personnel des écoles ou des garderies/crèches, peuvent aller à l'école/à la garderie/crèche

Les parents déclarent l'enfant malade auprès de l'école ou le personnel de l'école ou de la garderie/crèche se met en congé maladie  
Les élèves ainsi que le personnel de l'école ou de la garderie/crèche font pratiquer un post-test PCR dans l'un des centres de dépistage

Renouveler le test de dépistage avec du matériel neuf