


NOTICE D'UTILISATION ABRÉGÉE POUR L'AUTOTEST




Produit : Medicovid-AG® Autotest antigénique nasal SARS CoV-2
Fabricant : Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG


Premières étapes (Tous les composants sont à température ambiante)

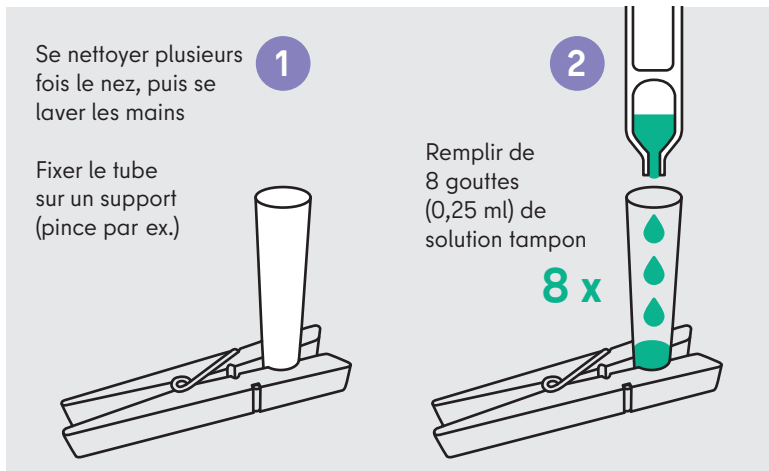


Prélèvement

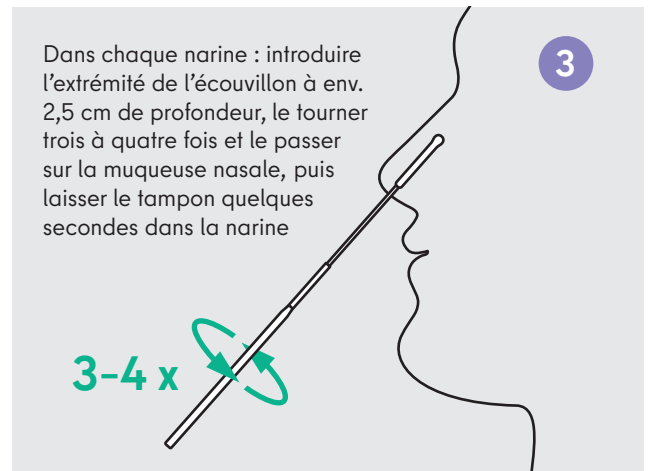

Traitement de l'échantillon

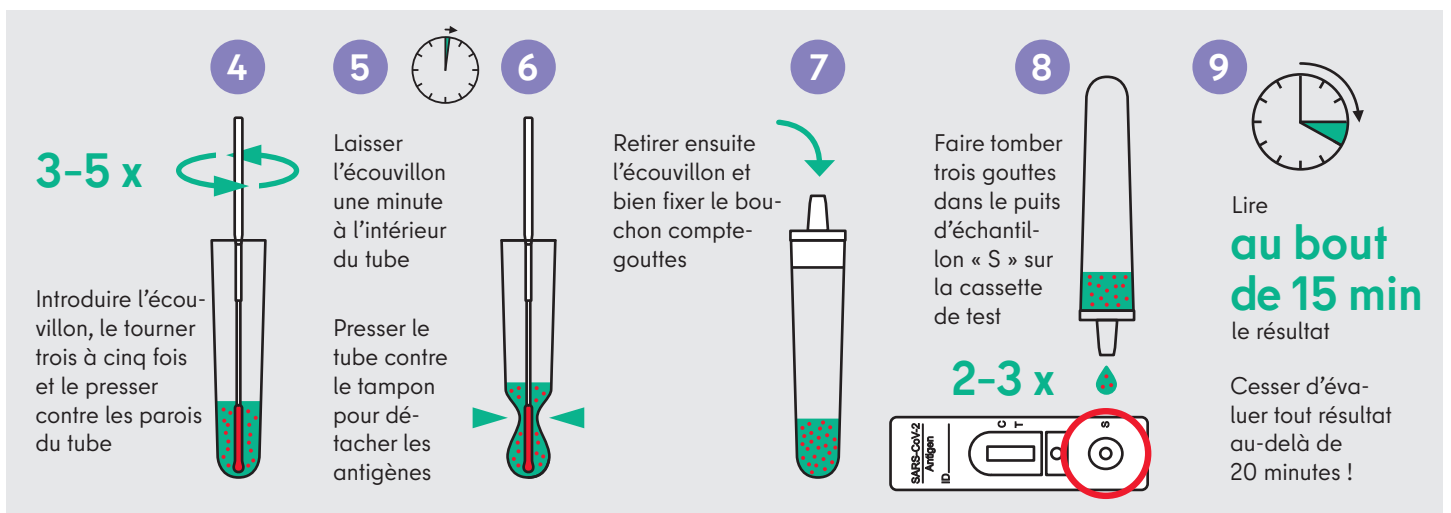

Évaluation des résultats

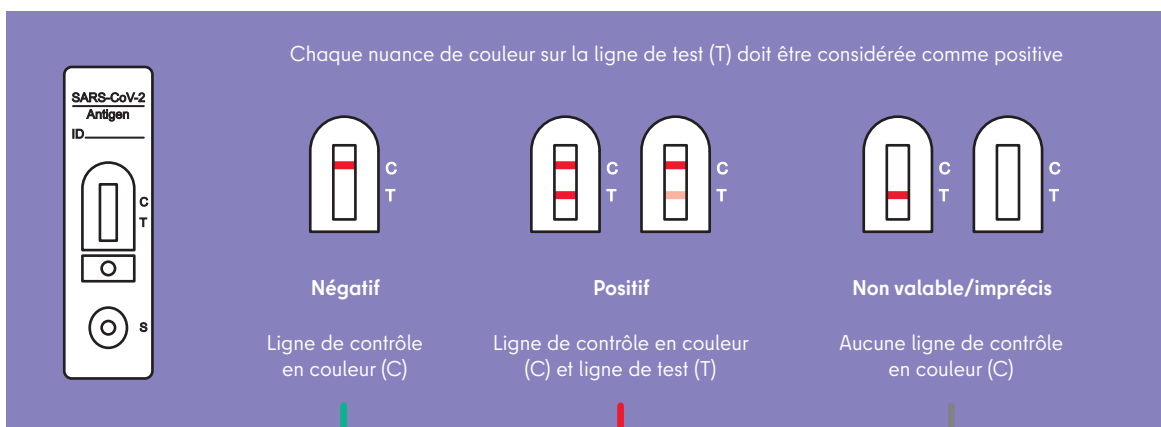

Élimination



Les élèves, ainsi que le personnel des écoles ou des garderies/crèches, peuvent aller à l'école/à la garderie/crèche

- Les parents déclarent l'enfant malade auprès de l'école ou le personnel de l'école ou de la garderie/crèche se met en congé maladie
- Les élèves ainsi que le personnel de l'école ou de la garderie/crèche font pratiquer un post-test PCR dans l'un des centres de dépistage

Renouveler le test de dépistage avec du matériel neuf