



# PM<sub>2,5</sub>-ÄQUIVALENZNACHWEIS

für die automatischen Geräte  
des Typs Grimm-EDM180  
des Berliner Luftgütemessnetzes  
für das Jahr 2021

Senatsverwaltung  
für Umwelt, Mobilität,  
Verbraucher- und Klimaschutz

**BERLIN**



## Impressum

### Herausgeber:

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz  
Berliner Luftgütemessnetz  
Brückenstraße 6  
10179 Berlin  
Tel.: 030-9025-0

### Bearbeitung:

Michaela Preuß, Sebastian Clemen, Dr. Katja Grunow, Dr. Heike Kaupp

### Stand:

August 2022

### Bezug des Berichts bei:

Michaela Preuß  
Tel.: 030-9025-2355  
E-Mail: [michaela.preuss@senumvk.berlin.de](mailto:michaela.preuss@senumvk.berlin.de)

### Titelbild:

Automatisches PM-Messgerät EDM180 der Firma Grimm in Betrieb, Quelle: Michaela Preuß (Berliner Luftgütemessnetz)

## Inhaltsverzeichnis

Impressum .....	2
Kurzzusammenfassung .....	4
1 Vergleichsgeräte und Orte .....	5
2 Bedingung an die Datensätze für die Überprüfung der Vergleichbarkeit der automatischen Messgeräte zur Referenzmethode (DIN EN 16450 7.5.8.2) .....	5
3 Ergebnisse .....	6
Anlage .....	8
Abbildungsverzeichnis .....	9
Tabellenverzeichnis .....	9
Referenzen .....	9

## Kurzzusammenfassung

An ausgewählten Berliner Standorten wurden PM<sub>2,5</sub>-Parallelmessungen der Automaten EDM180 der Firma Grimm zur gravimetrischen Referenz durchgeführt.

Die geforderte erweiterte Messunsicherheit von 25 % am Grenzwert von 25 µg/m<sup>3</sup> der automatischen Geräte zur Referenz wird nach Anwendung Korrekturfunktionen an allen Vergleichsorten im Jahr 2021 eingehalten.

Die Korrektur für die EDM180 ist seit 2018 pro Belastungsregime für PM<sub>2,5</sub>:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Städtisches Wohngebiet und Städtisches Randgebiet: | $0,80 \cdot \text{EDM180} + 1,3$ |
| 2. Straßen:   | $0,83 \cdot \text{EDM180} + 2,0$ |

Bei der Berechnung der erweiterten relativen Messunsicherheit wurde eine Messunsicherheit des Referenzverfahrens von 0,8 µg/m<sup>3</sup> verwendet.

Für den Gesamtdatensatz 2021 und alle Vergleichsorte beträgt die erweiterte relative Messunsicherheit 14,8 %, sie liegt damit unter 25 %.

Für alle Daten  $\geq 17 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (Gesamtdatensatz) wird die erweiterte Unsicherheit mit 19,6 % eingehalten.

In Anlage 6 Absatz A 4 der 39. BImSchV wird in Umsetzung der Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa die Referenzmethode für die Beurteilung der PM<sub>2,5</sub>-Konzentration nach DIN EN 12341:2014 festgelegt. Hier wird auch auf das Verfahren zum Nachweis der Gleichwertigkeit von automatischen Messverfahren zur Referenzmethode verwiesen. Die automatischen Messgeräte zur PM-Bestimmung werden gemäß DIN EN 16450:2017-07 betrieben.

# 1 VERGLEICHSGERÄTE UND ORTE IM JAHR 2021

- Im Berliner Luftgütemessnetz wird die PM<sub>2,5</sub>-Konzentration an 5 Stationen mit dem gravimetrischen Referenzverfahren gemäß 39.BImSchV erhoben. Dabei werden SEQ-Geräte der Firma Leckel (SEQ47/50-Geräte mit PM<sub>2,5</sub>-Kopf) eingesetzt.
- An allen 5 Stationen werden auch automatische PM<sub>2,5</sub>-Geräte betrieben, so dass als Vergleichsorte die folgenden Stationen zur Verfügung stehen:
  - an Straßen: DEBE065 (MC174),
  - im innerstädtischen Hintergrund DEBE034 (MC042); DEBE010 (MC010) und DEBE068 (MC171) sowie
  - am Stadtrand DEBE051 (MC077).
- Als automatische Messgeräte kommen ausschließlich EDM180 der Firma Grimm mit Software aus dem Eignungstest zum Einsatz.
- Nach DIN EN 16450:2017 Absatz 8.6.2 ist bis zur max. zulässigen erweiterten Messunsicherheit von 25 % eine Mindestanzahl von 5 Vergleichsorten festgelegt (siehe Tabelle 1). Diese Mindestanzahl wird erfüllt.

**Tabelle 1: Anzahl der notwendigen Vergleichsmessungen in Abhängigkeit der erweiterten Unsicherheit**

Erweiterte Unsicherheit in %	≤ 10	10-15	15-20	20-25
Anzahl Vergleichsmessungen	2	3	4	5

- Die SEQ-Geräte werden im klimatisierten Messcontainer mit folgenden Spezifikation betrieben: Motherboard Software 3.0.0, Motherboard Hardware 1.0.0, Kommunikationsmodul Software 5.0.0 oder 5.0.1, Kommunikationsmodul Hardware 2.0.0)
- Beim gravimetrischen Verfahren werden Quarzfaserfilter vom Typ MN QF-10 eingesetzt, welche vorbehandelt wurden (glühen, befeuchten, equilibrieren).
- Am MC077 erfolgt die gravimetrische Probenahme jeden 2. Tag, an allen anderen Stationen täglich.
- Die Wartung und Kalibrierung der kontinuierlichen Messgeräte und der Partikelsammler erfolgte im Routinebetrieb.
- Die Verfügbarkeit ist bei den SEQ und den EDM180 an allen Orten deutlich größer als 90 %.

## 2 BEDINGUNG AN DIE DATENSÄTZE FÜR DIE ÜBERPRÜFUNG DER VERGLEICHBARKEIT DER AUTOMATISCHEN MESSGERÄTE ZUR REFERENZMETHODE (DIN EN 16450 7.5.8.2)

1. Die Referenzmethode muss eine Unsicherheit < 2 µg/m<sup>3</sup> haben (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.3).
2. Die Kandidatenmethode (EDM180) muss eine Unsicherheit < 2,5 µg/m<sup>3</sup> haben (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.4).
3. Ausreißer dürfen mit bis zu 2,5 % entfernt werden – müssen begründet und dokumentiert werden. Danach muss jeder Datensatz noch mehr als 40 verwendete Datenpaare enthalten (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.2).
4. Mindestens 20 % der Daten müssen größer oder gleich der oberen Beurteilungsschwelle (70 % des Grenzwertes = 17 µg/m<sup>3</sup>) sein, wenn das nicht erreicht wird, müssen mindestens 32 Datensätze mit Werten oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle für den Vergleich vorhanden sein (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.2).
5. Die erweiterte kombinierte Messunsicherheit der Kandidaten muss bei PM<sub>2,5</sub> am Grenzwert von 25 µg/m<sup>3</sup> ≤ 25 % sein (DIN EN 16450:2017; 7.5.8.5):
  - für alle Ergebnisse zusammen,
  - für alle ≥ 17 µg/m<sup>3</sup>,
  - für Datensätze für jeden einzelnen Standort.

Der Nachweis für EDM180 wird durch die Anwendung der orthogonalen Regression mittels Excel-Sheet [Equivalence Tool V3.1] durchgeführt.

## 3 ERGEBNISSE

1. Die Unsicherheit der Referenzmethode wird seit mehreren Jahren laufend mittels Parallelmessungen SEQ zu SEQ an zwei Messstationen (MC174 und MC042) ermittelt. Bei den SEQ 47/50 Geräten der Firma Leckel wurde für PM<sub>10</sub> eine Unsicherheit von 0,8 µg/m<sup>3</sup> gefunden und verwendet. In früheren Untersuchungen wurde am MC171 über ca. 1 Jahr neben PM<sub>10</sub>- auch PM<sub>2,5</sub>-Unsicherheiten bestimmt und kein Unterschied festgestellt. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass diese Unsicherheit auf PM<sub>2,5</sub> übertragbar ist.
2. Die Unsicherheit der Kandidatenmethode (EDM180) wird ebenfalls seit mehreren Jahren durch Parallelmessungen am MC174 für PM<sub>2,5</sub> ermittelt und für den Gesamtdatensatz des Jahres 2021 mit 0,8 µg/m<sup>3</sup> und für den Datensatz  $\geq 17$  µg/m<sup>3</sup> mit 0,9 µg/m<sup>3</sup> ermittelt.
3. Es wurden 0,4 % Ausreißer entfernt. 1594 Datenpaare wurden für den Äquivalenzvergleich 2021 berücksichtigt (siehe Tabelle 2). Pro Messstation wurden maximal 0,6 % Ausreißer entfernt.
4. Die Mindestanzahl der Daten oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle wird im Zeitraum 01.01.2021-31.12.2021 nur beim MC174 erreicht. Beim MC077 reichen die Daten oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle nicht aus. Alle anderen Messorte haben mehr als 32 Datensätze größer oder gleich 17 µg/m<sup>3</sup> (siehe Tabelle 2).
5. Die erweiterte Messunsicherheit der automatischen Geräte zur Referenz wird ohne Korrekturfunktion nicht eingehalten. Eine Korrektur für die EDM180 pro Belastungsregime ist erforderlich mit
  - städtisches Wohngebiet und städtisches Randgebiet:  $0,80 \cdot \text{EDM180} + 1,3$
  - Straßen:  $0,83 \cdot \text{EDM180} + 2,0$
 Das verbessert die Vergleichbarkeit und ermöglicht den Nachweis der Gleichwertigkeit im Jahr 2021. Es wurde für alle Ergebnisse zusammen, für jeden Messort einzeln und für alle Daten  $\geq 17$  µg/m<sup>3</sup> der Äquivalenztest durchgeführt und die erweiterte Unsicherheit von  $\leq 25$  % am Grenzwert von 25 µg/m<sup>3</sup> eingehalten.
  - Der Vergleich der Tagesmittelwerte aller Vergleichsorte (MC174, MC042, MC010, MC077 und MC171) zwischen SEQ (Referenzmethode RM) und Automaten (Kandidatenmethode CM) ist in Abbildung 1 dargestellt. Die zulässige erweiterte Unsicherheit von  $\leq 25$  % ist eingehalten.
  - Pro Messort beträgt die erweiterte Messunsicherheit zwischen 13,7 % und 18,0 % (siehe Anlage).

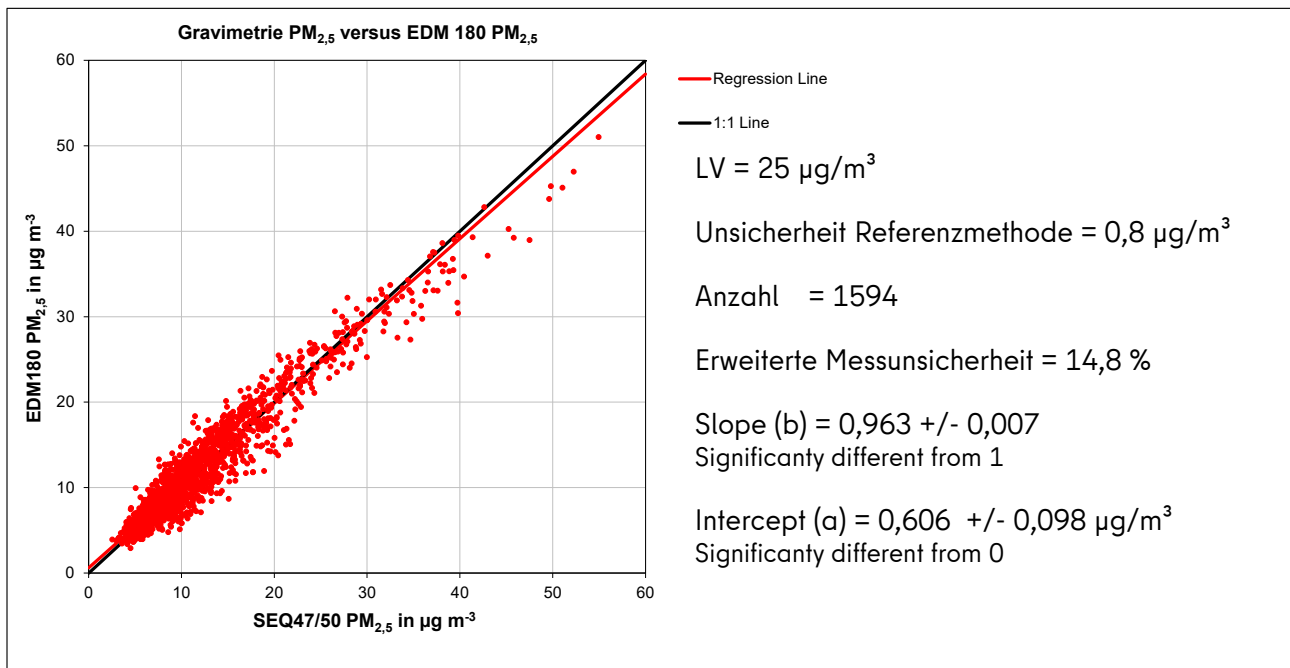
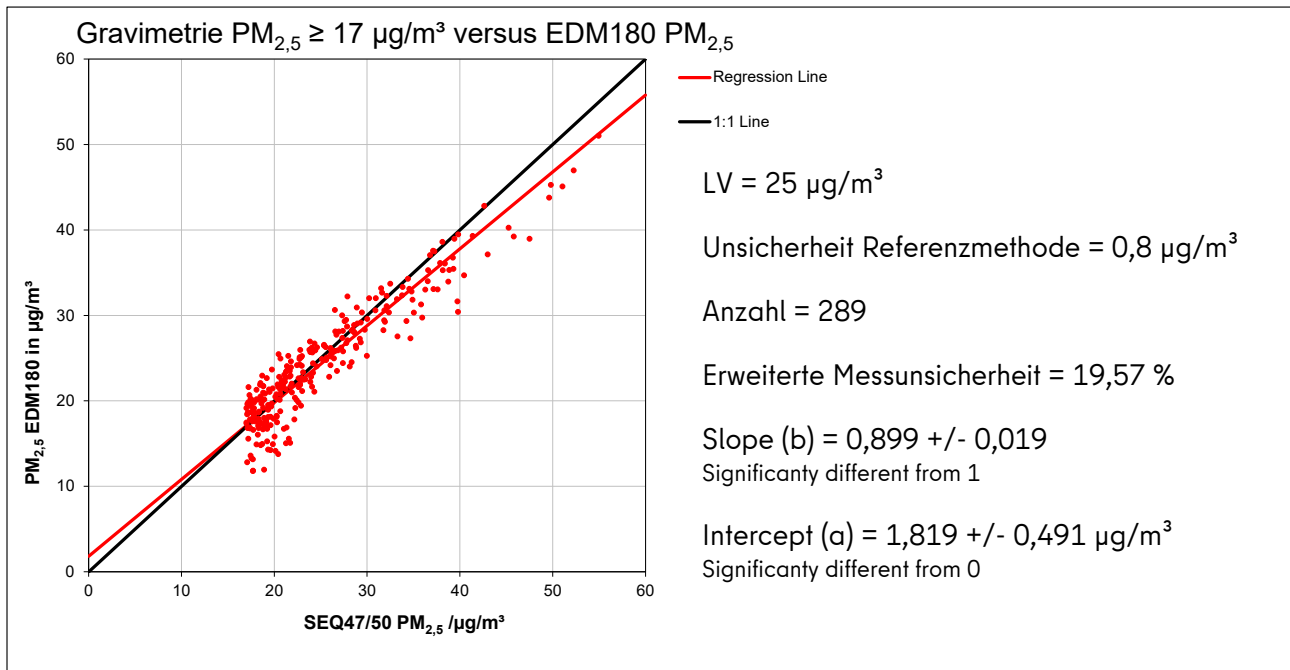


Abbildung 1: Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC010, MC171, MC077 für den Datensatz vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 [berechnet mit Equivalence Tool V3.1] durchgeführt.

Auch für die Daten  $\geq 17 \mu\text{g}/\text{m}^3$  wird die erweiterte Messunsicherheit mit 19,6 % eingehalten (Abb. 2):



**Abbildung 2: Werte  $\geq 17 \mu\text{g}/\text{m}^3$  Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC010, MC171, MC077 für den Datensatz vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 [berechnet mit Equivalence Tool V3.1]**

Die detaillierten Ergebnisse aus dem Equivalence Tool V3.1 sind der Anlage Tabelle 2 zu entnehmen.

**Damit ist die Gleichwertigkeit der PM<sub>2,5</sub>-Werte der automatischen Geräte zur Referenz für das Jahr 2021 nachgewiesen.**

## Anlage

Die folgenden Kennwerte wurden erstellt unter Verwendung des Auswertetools: [Equivalence Tool V3.1] und RIVM 2012:

**Tabelle 2: Kennwerte des Jahres 2021 der Parallelmessungen von Grimm-EDM180-Geräten (Kandidatenmethode) zu SEQ-Innengeräten 47/50 (Referenzmethode)**

Messtation	MC042	MC174	MC077	MC171	MC010	alle Vergleichs-MC
EDM180 Korrektur-Funktion 2018 (f. 2019 bis 2021 fortgeschrieben)	0,8*EDM180 +1,3	0,83*EDM180 +2,0	0,8*EDM180 +1,3	0,8*EDM180 +1,3	0,8*EDM180 +1,3	EDM180 mit jeweiliger Funktion
Mittelwerte und Anzahl aus EU-Sheet:						
Mittelwert EDM180 in µg/m <sup>3</sup>	12,6	14,5	11,4	12,7	11,5	12,7
Mittelwert SEQ in µg/m <sup>3</sup>	12,9	13,9	10,6	12,3	11,9	12,5
Differenz EDM180-SEQ in µg/m <sup>3</sup>	-0,6	-0,1	0,1	-0,3	-0,1	-0,2
Anzahl Werte ohne Ausreißer	358	358	182	335	361	1594
Regressions-Kennwerte						
relative beidseitige Messunsicherheit <sup>1)</sup> in % am Grenzwert von 25 µg/m <sup>3</sup>	17,9	14,3	18,0	13,7	14,8	14,8
RM <sup>2)</sup> =b*CM <sup>2)</sup> Steigung b	1,04	0,97	0,94	0,99	1,04	1,0
RM=b*CM+a Steigung b	1,08	1,03	0,99	1,03	1,05	1,04
Achsenabschnitt a	-0,66	-1,1	-0,7	-0,78	-0,16	-0,63
Regressionskoeffizient R <sup>2</sup>	0,92	0,94	0,89	0,93	0,93	0,92
Anzahl Daten über oberer Beurteilungsschwelle (oBs) und Ausreißer						
20% der Daten SEQ (Anzahl)	71	71	36	67	72	318
20% der Daten SEQ > 17 µg/m <sup>3</sup> (oBs <sup>3)</sup> )	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Anzahl Datensätze > 17 µg/m <sup>3</sup> (oBs)	71	82	21	58	57	289
Mindestanzahl > 17 µg/m <sup>3</sup> erreicht <sup>3)</sup>	ja	ja	nein	ja	ja	ja
Ausreißer in % (max. 2,5% Ausreißer?)	0,3	0,3	0,5	0,6	0,3	0,4

<sup>1)</sup> Gemessene Messunsicherheit zwischen den SEQ-Innengeräten: 0,8 µg/m<sup>3</sup>

<sup>2)</sup> RM = Referenzmethode (engl. reference method), hier: SEQ-Messungen; CM = Kandidatenmethode (engl. candidate methode); hier EDM180-Messungen

<sup>3)</sup> Es müssen mindestens 20 % der Daten oberhalb der oberen Beurteilungsschwelle liegen. Wenn dies nicht erreicht wird, müssen mindestens 32 Datensätze vorhanden sein, um die Prüfung auf Äquivalenz durchführen zu können.



## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC010, MC171, MC077 für den Datensatz vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 [berechnet mit Equivalence Tool V3.1] durchgeführt.....	6
Abbildung 2:	Werte $\geq 17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Vergleich Automat (CM) zu SEQ (RM) am MC174, MC042, MC010, MC171, MC077 für den Datensatz vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 [berechnet mit Equivalence Tool V3.1].....	7

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Anzahl der notwendigen Vergleichsmessungen in Abhängigkeit der erweiterten Unsicherheit.....	5
Tabelle 2:	Kennwerte des Jahres 2021 der Parallelmessungen von Grimm-EDM180-Geräten (Kandidatenmethode) zu SEQ-Innengeräten 47/50 (Referenzmethode).....	8

## Referenzen

39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39. BImSchV), [https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv\\_39/](https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_39/) (Stand 08.07.2022)
- DIN EN 12341 - Außenluft - Gravimetrisches Standardmessverfahren für die Bestimmung der  $\text{PM}_{10}$ - oder  $\text{PM}_{2,5}$ -Massenkonzentration des Schwebstaubes; Deutsche Fassung EN 12341:2014
- DIN EN 16450:2017-07: Außenluft - Automatische Messeinrichtungen zur Bestimmung der Staubkonzentration ( $\text{PM}_{10}$ ;  $\text{PM}_{2,5}$ ); Deutsche Fassung EN 16450:2017. Beuth-Verlag. <https://www.beuth.de/de/norm/din-en-16450/261291177> (Stand 08.07.2022)
- EQUIVALENCE TOOL V3.1 020720 (2).XLSX (Version 1.0): Excel-Datei zum Nachweis der Äquivalenz eines Kandidatenverfahrens mit einem Referenzverfahren gemäß 39.BImSchV. Erstellt von David HARRISON Version 1.0 vom 31.05.2022, 11:11; <https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/ece2498e-2ca5-4817-8bfa-30521190f166> (Stand 08.07.2022)
- GDE 2010: GUIDE TO THE DEMONSTRATION OF EQUIVALENCE OF AMBIENT AIR MONITORING METHODS; Deutscher Titel: „Leitfaden zur Demonstration der Gleichwertigkeit der Methoden zur Überwachung der Umgebungsluft“, Europäische Kommission, Januar 2010, <https://circabc.europa.eu/ui/group/cd69a4b9-1a68-4d6c-9c48-77c0399f225d/library/ece2498e-2ca5-4817-8bfa-30521190f166> (Stand 08.07.2022)
- RIVM 2012: Ruben Beijl, Version 2.9 vom März 2012. Excel-Datei zum Nachweis der Äquivalenz eines Kandidatenverfahrens mit einem Referenzverfahren gemäß 39.BImSchV. Erstellt vom RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Dutch Institute for Public Health and the Environment, dep. Centre for Environment Monitoring., [https://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/RIVM\\_PM\\_equivalence\\_v2.9.xls](https://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/pdf/RIVM_PM_equivalence_v2.9.xls) (Stand 03.06.2021)



Öffentlichkeitsarbeit  
Am Kölnischen Park 3  
10179 Berlin

[www.berlin.de/sen/umvk](http://www.berlin.de/sen/umvk)  
[twitter.com/senumvkberlin](https://twitter.com/senumvkberlin)  
[instagram.com/senumvkberlin](https://www.instagram.com/senumvkberlin)

Berlin, 08/2022